


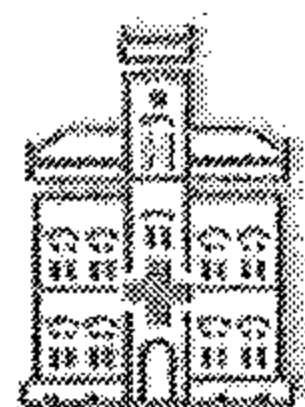

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – Потрошни материјал за ендоваскуларни третман ИК анеуризама бр. 315А/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 06.07.2016. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Да ли ће бити прихватљиве спирале следећег описа спиралама које су описане у 1. партији:
Платинијумске спирале 360 технологије, отпорне на истезање, дебљине 10,18 величине 2-20mm, дужине 3-60cm са ултра брзим електрично механичким отпуштањем?
2. Да ли ће бити прихватљиве спирале следећег описа спиралама које су описане у 2 партији:
Платинијумске спирале 360 технологије, отпорне на истезање, дебљине 10,18 величине 2-20mm, дужине 3-60cm са ултра брзим електрично механичким отпуштањем
3. Да ли ће бити прихватљив микрокатетер следећег описа микрокатетеру који је описан у партији 3/1:
Хидрофилни микрокатетер дужине 150cm, са 2 маркера на врху, проксимални спољашњи лумен 2.8F, дистални 2.3f, унутрашњи лумен 0.017 инча, са 7-сегментном транзицијом и хидрофилним омотачем у дужини од 100cm и са могућношћу обликовања и задржавања облика за веома изувијане крвне судове?
4. Да ли ће бити прихватљив микрокатетер следећег описа микрокатетеру који је описан у партији 4/1:
Хидрофилни микрокатетер дужине 150cm, са 2 маркера на врху, проксимални спољашњи лумен 2.8F, дистални 2.3f, унутрашњи лумен 0.017 инча, са 7-сегментном транзицијом и хидрофилним омотачем у дужини од 100cm и са могућношћу обликовања и задржавања облика за веома изувијане крвне судове?

ОДГОВОР:

1. Није прихватљива понуда јер су тражене спирале од платине промера 0.010 i.0.020 инча са ултра брзим механичким одвајањем, standard, soft, J, промера 2 до 24 mm и дужина од 3 до 60 cm.
2. Није прихватљива понуда јер су тражене спирале од платине за испуњавање анеуризми са ултра брзим електролитним одвајањем, дебљине 10, 14, 18, различитих облика, чврстоће и величина од 2-20mm у промеру и дужина од 1-30cm.
3. Није прихватљива понуда јер су тражени хидрофилни микрокатетери ултра танког зида са два дистална маркера у размаку од 3cm компатибилни са жицом 0.010 проксималног промера 2.1F, дисталног промера 1.7F укупне дужине 155cm, са различитим облицима дисталног дела: раван, 45, 90.
4. Није прихватљива понуда јер су тражени хидрофилни микрокатетери ултра танког зида са два дистална маркера у размаку од 3cm компатибилни са жицом 0.010 проксималног промера 2.40F, дисталног промера 1.9F укупне дужине 155cm, са различитим облицима дисталног дела: раван, 45, 90.